

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di Indagine di mercato: informatizzazione di n. 2 postazioni aggiuntive.

Questa ARNAS, dovendo acquisire n° 2 moduli multiparametrici per due postazioni aggiuntive dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione di Nesima, per i quali sembrerebbe sussistere specificità, procede alla presente indagine di mercato onde avere eventuale conferma della stessa o verificare l'esistenza sul mercato di prodotti equivalenti ex art. 68 D.lg.50/2016. (Codice Appalti). Qualora si rilevi che trattasi di prodotto esclusivo, la presente è volta anche a verificare l'eventualità che più ditte commercializzano la medesima attrezzatura.

Si attenzi che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it


Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Sig. Raimondo Vinci, tel. 095/7594851 – fax 095/7594908

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

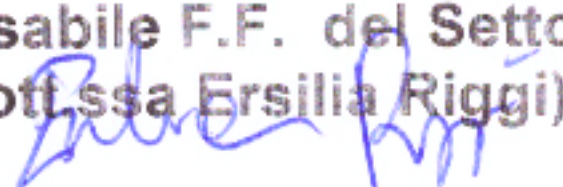

Di seguito le caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche

Pertanto si chiede alla S.V. l'aggiornamento tecnologico di queste due postazioni in modo da consentire l'aggiornamento anche di queste due postazioni al fine di informatizzarle per l'inserimento nella cartella clinica informatizzata.

Le caratteristiche tecniche necessarie devono essere uguali, alle altre già aggiornate in modo da consentire la scambiabilità dei moduli, l'interfacciabilità alla centrale di monitoraggio e chiaramente l'utilizzo della stessa cartella clinica informatizzata già esistente.

Caratteristiche tecniche:

- Display touchscreen non inferiore a 19" wudw screen.
- Unità portamoduli a 4 vani
- Modulo multiparametrico per il rilevamento di: ECG 12 der, SPO2, NIBP, Temp/IBP; dotato di schermo touchscreen non inferiore a 3", per la visualizzazione dei parametri fisiologici del paziente durante eventuale trasporto e/o trasferimento.
- Modulo interfaccia per ventilatore interfaccia Drager Evita XL in ns dotazione.
- Funzione software di valutazione SEPSI e EWS.

I monitor richiesti devono consentire le seguenti essenziali funzionalità:

- Interscambiabilità dei moduli con gli attuali monitor Philips IntelliVue mod. MX800 in nostra dotazione;